

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LOS COJINES SPEX CONSTRUCTA



Constructa  
Shape



Constructa  
Flex




## AJUSTE DE BASE POSICIONAMIENTO DE CONSTRUCTA SHAPE

Oblicuidad pélvica

3 cm


Levante los bloques de espuma pélvicos hasta la altura requerida en la parte posterior del cojín, luego ajuste los bloques de espuma de los muslos hacia la parte delantera del cojín.

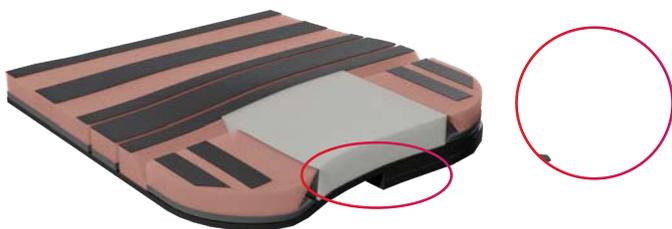

Base preisquiática elevada

3 cm

Si necesita una base preisquiática más alta, coloque los bloques de posicionamiento de los muslos debajo de la base del cojín.

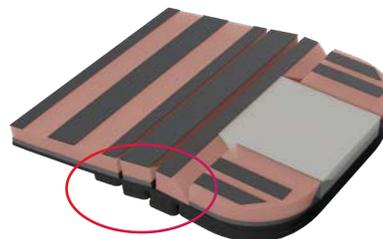

## AJUSTE DE BASE POSICIONAMIENTO DE CONSTRUCTA FLEX

Longitud de las piernas

-2,5 cm

Discrepancia en la longitud de las piernas


Con el Constructa Flex se puede ajustar la longitud de las piernas. Utilice los elementos que permiten la extensión y el giro para acortar la longitud o ajustar las discrepancias.



Oblicuidad pélvica

5 cm


Para ajustar la oblicuidad pélvica, simplemente agregue o retire los bloques isquiáticos.

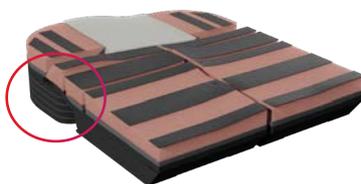

Rotación interna y externa

7.5°

Gire la cuña de la pierna para ajustarla a la rotación del muslo.

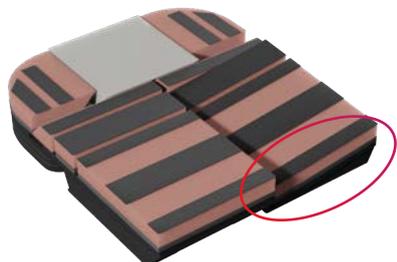


Abducción de cadera

30°

Postura en ráfaga

15°


Para ajustar las piernas, primero retire los bloques del trocánter. Esto le permitirá mover fácilmente los elementos que permiten el giro. Vuelva a colocar los bloques del trocánter después de realizar el ajuste.

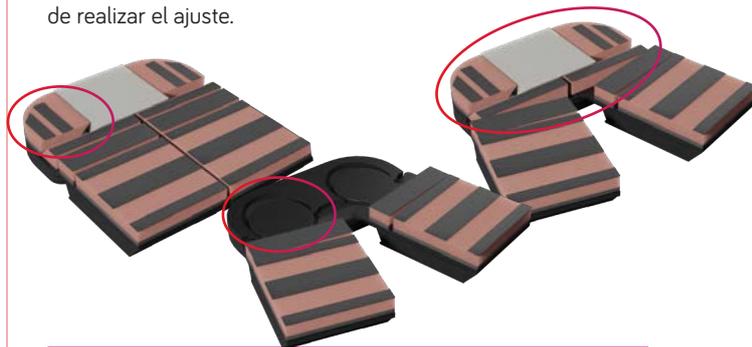

Flexión de cadera

15°


El ángulo de flexión de la cadera se puede ajustar para cada pierna. Para un mayor ajuste de flexión, gire la cuña inferior 180°. Al ajustar el ángulo de la cadera, asegúrese de para ajustar los bloques de la pelvis a una altura adecuada.

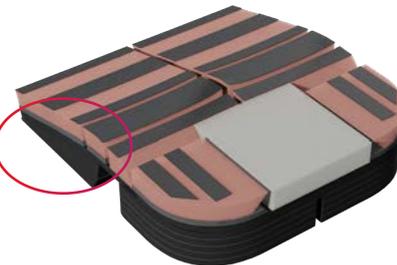

# BLOQUEO DE POSICIONAMIENTO Y AJUSTE DE CONTORNO: SHAPE & FLEX

## Espuma confort

La espuma confort proporciona inmersión y distribución de presión y puede cubrir espacios de hasta 3 cm de ancho. El cojín debe evaluarse y utilizarse con la espuma de confort.

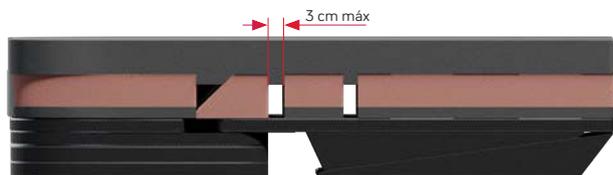


## Ajuste del bloque del trocánter pélvico & Anchura del muslo

-5 cm

Ajuste el ancho de la hondonada pélvica para soportar los trocánteres mayores y distribuir la presión.

Al mover los contornos pélvicos laterales, asegúrese de mover los bloques del trocánter con ellos.


Compruebe que el borde interior del contorno no cruce el corte en el bloque del trocánter.

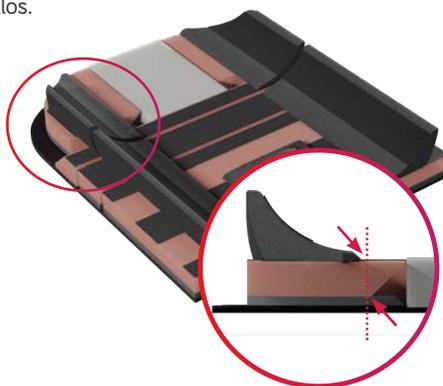

## Longitud de las piernas


-5 cm

Al acortar la longitud del cojín, acerque los bloques o retire el bloque del muslo de 5 cm. Haga que el exceso de capa base sobresalga de la parte posterior del cojín. De esta manera se puede meter debajo del respaldo y mantenerlo apartado.

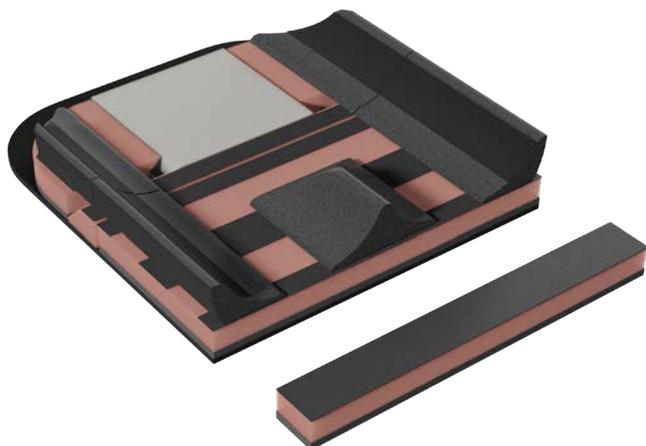

## Pase preisquiática

Ajuste la posición de la base preisquiática para contener la pelvis en la hondonada pélvica. Mantenga la base preisquiática cuadrada con la hondonada pélvica si los muslos están en abducción.

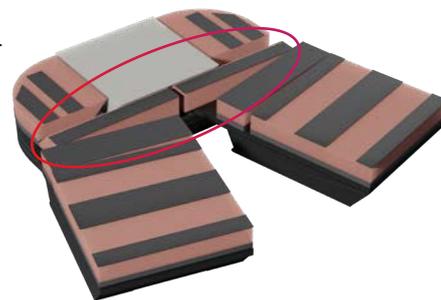

## Contornos de soporte para muslos Abducción de cadera

10°  
(5° cada pierna)

Ajuste los contornos del soporte lateral de muslos y del abductor para controlar la posición de los muslos. Al ajustar los contornos, asegúrese de que toda la base del contorno esté apoyada en el cojín.

